www.has.ru

ХРОМОС
инжиниринг

Хромос УПБ-1

Устройство для подогрева баллонов

Хромос УПБ-1 используется для прогрева баллона в процессе его откачки на стадии подготовки при отборе проб методом вакуумирования по ГОСТ 31370-2008.

от 50 до 110°С
поддерживаемая температура камеры

Особенно важно

Вентиль (вентили) баллона находятся вне зоны активного нагрева!

Теплоизолированная крышка и дно имеют отверстия для вентилей. Причем, за счет специальной теплоизолированной вставки, это обеспечивается даже для коротких 4-литровых 2-вентильных баллонов.

Различие в высоте 9-10 литровых баллонов удачно компенсируется глубиной погружения.

ХРОМОС
инжиниринг

Устройство термостата позволяет помещать в него баллоны различных производителей вместимостью до 10 литров, в частности:

1. алюминиевый 4-литровый баллон БД-12-4-9,8 (как 1-вентильный, так и 2-вентильный)
2. алюминиевый 10-литровый баллон БД-12-10-9,8 с внешним диаметром 160 мм
3. металлический композиционный 4-литровый баллон БМК 300В-4-2-1-2
4. металлический композиционный 9-литровый баллон БМК 300В-9-2-1-2 с внешним диаметром 150 мм
5. импортный баллон «LUXFER» с внешним диаметром 170 мм

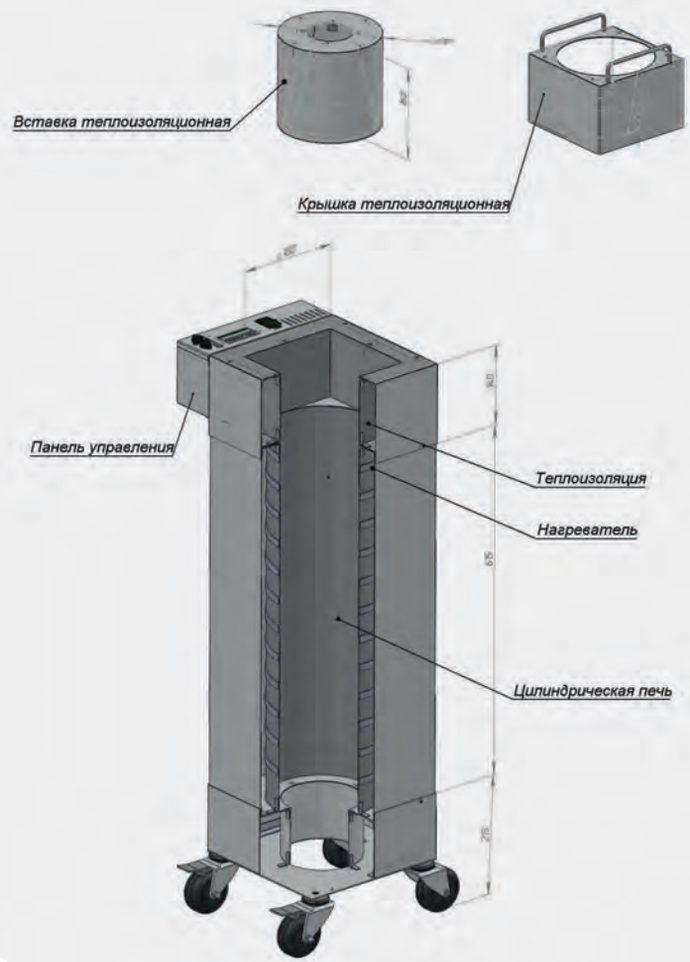

Россия, 606002, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 20, корпус 83
8 8313 24-92-00, mail@has.ru, **www.has.ru**

Мы работаем во всех регионах России, а также за рубежом.